

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Время-Ч»

_____ А.А. Беляев

« ____ » _____ 2016 г.

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ ВЧ
VCH-605

Руководство по эксплуатации

Методика поверки

Приложение Б

(обязательное)

ЯКУР.468732.022РЭ1

Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Время-Ч»

_____ Б.А. Сахаров

« ____ » _____ 2016 г.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	Общие сведения	3
2	Операции поверки.....	4
3	Средства поверки	5
4	Требования к квалификации поверителей.....	6
5	Требования безопасности.....	7
6	Условия поверки	8
7	Подготовка к поверке	9
8	Проведение поверки	10
8.1	Внешний осмотр.	10
8.2	Опробование.....	10
8.3	Определение (контроль) метрологических характеристик.....	10
9	Выключение прибора	15
10	Оформление результатов поверки	16

Перв. примен.	
Справ. №	

	Подп. и дата		Индв. № дубл.		Взамен инв. №		Подп. и дата		Индв. № подл.	
--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	---------------	--

ЯКУР.468732.022РЭ1		

1	Зам.	ЯКУР.066-2016							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
	Разраб.	Синельников							
	Пров.	Пелюшенко							
	Согл.								
	Н.контр.	Киселева							
	Утв.	Сахаров							

ЯКУР.468732.022РЭ1 Усилитель сигналов ВЧ VCH-605 Руководство по эксплуатации Методика поверки Приложение Б (обязательное)			Лит.	Лист	Листов
			2	17	
ЗАО «Время-Ч»					

1 Общие сведения

Настоящая методика поверки распространяется на усилитель сигналов ВЧ (далее – прибор) и устанавливает методы и средства первичной, периодической и внеочередной поверок, проводимых в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 и ГОСТ РВ 8.576-2000.

Продолжительность первичной поверки прибора составляет 7 часов.

Продолжительность периодической поверки прибора составляет 2 часа.

Межповерочный интервал – 1 год.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1	Зам.	ЯКУР.066-2016		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЯКУР.468732.022РЭ1

	Лист
	3

2 Операции поверки

Перед проведением поверки прибора проводится внешний осмотр и операция подготовки его к работе.

Метрологические характеристики, подлежащие проверке, и операции поверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики, подлежащие проверке, и операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Обязательность поверки параметров		
		первичная поверка		периодическая поверка
		при выпуске	после ремонта	
Внешний осмотр	8.1	да	да	да
Опробование	8.2	да	да	да
Проверка коэффициента усиления вход/выход	8.3.1	да	да	да
Проверка развязки между каналами	8.3.2	да	да	да
Проверка гармонических искажений	8.3.3	да	да	да
Проверка вносимой прибором нестабильности частоты	8.3.4	да	да	нет
Проверка вносимой прибором спектральной плотности мощности фазовых шумов	8.3.5	да	да	нет

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата

1	Зам.	ЯКУР.066-2016			ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Средства поверки

Рекомендуемые средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендуемые средства поверки

Наименование средств поверки	Требуемые технические характеристики средств поверки		Рекомендуемое средство поверки (тип)
	пределы измерения	погрешность	
Анализатор фазовых шумов	5–30 МГц 10–400 МГц	1 Гц – 145 дБ/√Гц; 10 кГц – 175 дБ/√Гц	TSC 5120A TSC 5125A
Генератор ВЧ	9кГц – 3,0ГГц	Разрешение по частоте 0,1 Гц	N9310A
Частотный компаратор	Частота входных сигналов 5; 10; 100 МГц с отклонением от номинального значения $\pm 1,0 \cdot 10^{-6}$	Погрешность, вносимая компаратором (среднее квадратическое относительное случайное двух- выборочное отклонение): $2,0 \cdot 10^{-14}$ при интервале времени измерения 1 с;	VCH-314
Стандарт частоты и времени водородный	Частота выходных сигналов 5; 10; 100 МГц	СПМФШ относительно несущей: 10 Гц: -130 дБ/Гц 100 Гц: -140 дБ/Гц 1 кГц: -150 дБ/Гц 10 кГц: -155 дБ/Гц	Ч1-1007
Анализатор спектра	9 кГц – 1500 МГц	Измерение уровня $\pm 0,4$ дБ Пределы измерения уровня -140...30 дБм	E4402B
Нагрузка 50 Ом	Диапазон частот от DC до 3 ГГц		65_SMA-50-0-20/111
Делитель мощности	Диапазон частот от 1 до 750 МГц		ZFSC-2-1W-S+
Фильтр нижних частот 5 МГц	0-5 МГц	Подавление гармонических составляющих 5 МГц не менее 25 дБ.	ЯКУР.468822.005 ЗАО «Время-Ч»
Фильтр нижних частот 10 МГц	0-10 МГц	Подавление гармонических составляющих 10 МГц не менее 25 дБ.	ЯКУР.468822.006 ЗАО «Время-Ч»
Фильтр нижних частот 100 МГц	0-100 МГц	Подавление гармонических составляющих 100 МГц не менее 20 дБ.	ЯКУР.468822.007 ЗАО «Время-Ч»

Примечание – вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства измерений, обеспечивающие необходимую точность и диапазоны измерений.

Применяемые при поверке средства измерений и рабочие эталоны должны быть утвержденного типа, исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в технической документации.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Подп. и дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6 Условия поверки

При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Условия проведения операций поверки

Температура окружающего воздуха, °С (К)	20±5 (293±5)
Относительная влажность воздуха при температуре до 25 °С, %	65±25
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)
Питание от сети переменного тока:	
- напряжением, В;	220±4,4
- частотой, Гц.	50,0±0,5
- содержание гармоник, %, не более	5

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата

					ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

7 Подготовка к поверке

7.1 Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемого стандарта и используемых средств поверки.

Перед проведением операций поверки необходимо:

- проверить комплектность поверяемого прибора для проведения поверки (наличие кабелей питания и пр.);

- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) необходимые рабочие эталоны, средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, указанным в технической документации равного 2 часам).

7.2 Перед проведением поверки необходимо подготовить прибор к работе в следующей последовательности:

- перед началом работы обеспечить надежное заземление прибора, для чего зажим защитного заземления присоедините к шине заземления раньше других соединений, крепления заземляющей клеммы и проводников должны быть надежно зафиксированы;

- подключить питание прибора.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата	ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

Произвести внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии внешних механических повреждений и неисправностей, влияющих на работоспособность.

При проведении внешнего осмотра проверяется:

- сохранность пломб;
- чистота и исправность разъемов и гнезд;
- ослабление элементов конструкции;

Приборы, имеющие дефекты (механические повреждения), бракуют и направляют в ремонт.

8.2 Опробование

Для опробования работы прибора и оценки его исправности необходимо подключить к нему переменное напряжение 220 В. При этом должен загореться только индикатор **СЕТЬ** на передней панели. Подключить ко входу А синусоидальный сигнал частотой от 5 до 100 МГц и мощностью от 7 до 17 дБм. При этом должны загореться соответствующие индикаторы выходов канала А. Аналогично проверяются каналы В и С.

8.3 Определение (контроль) метрологических характеристик

8.3.1. Определение коэффициента усиления вход/выход производят с помощью генератора сигналов N9310A и анализатора спектра E4402B. Генератор сигналов подключают к анализатору спектра и подают синусоидальный сигнал мощностью (13 ± 1) дБм и, устанавливая частоты на выходе генератора $(5 \pm 0,00005)$, $(10 \pm 0,0001)$ и $(100 \pm 0,001)$ МГц, измеряют уровень сигнала на анализаторе спектра. Генератор сигналов отключают от анализатора спектра и подключают к входу поверяемого прибора. Устанавливая частоты на выходе генератора $(5 \pm 0,00005)$, $(10 \pm 0,0001)$ и $(100 \pm 0,001)$ МГц, измеряют уровень сигнала на выходах поверяемого прибора анализатором спектра. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если разность между измеренными мощностями на выходе генератора и прибора на одинаковых частотах не превышает 1 дБ.

Если указанные требования не выполняются, то прибор бракуется и отправляется в ремонт.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

									Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016							10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ЯКУР. 468732.022РЭ1

8.3.2. Определение развязки между каналами в приборе производят с помощью генератора сигналов N9310A и анализатора спектра E4402B. Длины соединительных кабелей должны быть не более 60 см. Неиспользуемые входы и выходы прибора заглушают нагрузками 65_SMA-50-0-20/111.

Развязка выход/выход определяется следующим образом. Выход генератора сигналов подключают к выходу «A1» прибора. Анализатор спектра подключают к выходу «A2» прибора. На генераторе сигналов устанавливают синусоидальный сигнал мощностью (13 ± 1) дБм и последовательно частоты $(5 \pm 0,00005)$, $(10 \pm 0,0001)$ и $(100 \pm 0,001)$ МГц, измеряя при этом анализатором спектра мощность сигналов на этих частотах. Анализатор спектра переключают на выход «A3» и так же измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах. Анализатор спектра переключают на выход «A4» и так далее до «C4».

Выход генератора сигналов подключают к выходу «A2» прибора. Анализатор спектра подключают на выход «A3», «A4»...«C4» и измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах. Аналогичным образом промеряют все остальные выходы.

Развязка выход/вход определяется следующим образом. Выход генератора сигналов подключают к выходу «A1» прибора. Анализатор спектра подключают к входу «A» прибора и измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах. Выход генератора сигналов подключают к выходу «A2», «A3»...«C4» прибора и так же измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах.

Анализатор спектра подключают к входу «B» прибора. Подключая выход генератора сигналов на выходы «A1», «A2»...«C4», измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах. Аналогично измеряют развязку для входа «C».

Развязка вход/вход определяется следующим образом. Выход генератора сигналов подключают к входу «A» прибора. Анализатор спектра подключают к входу «B» (а затем «C») прибора и измеряют мощности сигналов на всех 3-х частотах. Аналогично измеряют развязку между входами «B» и «C».

Из измеренных мощностей необходимо вычесть 13 дБм.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученные значения развязки не более минус 120 дБ на частотах 5 и 10 МГц и не более минус 100 дБ на частоте 100 МГц.

Если указанные требования не выполняются, то прибора бракуется и отправляется в ремонт.

8.3.3. Определение уровня гармонических искажений, вносимых прибором, проводят с помощью генератора сигналов N9310A, анализатора спектра E4402B и фильтров нижних

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Изн. № дубл.
Взамен инв. №	Подп. и дата
	Изн. № дубл.

					ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

частот ЯКУР.468822.005, ЯКУР.468822.006, ЯКУР.468822.007. При наличии генератора сигналов с гармоническими искажениями на выходе лучше более чем на 10 дБ, чем требуется для проверки прибора, фильтры нижних частот можно не использовать.

Для определения гармонических искажений, вносимых прибором, на частоте 5 МГц генератор сигналов через фильтр нижних частот 5 МГц (ЯКУР.468822.005) подключают на вход «А» прибора. К выходу «А1» прибора подключают анализатор спектра. На генераторе устанавливают синусоидальный сигнал частотой $(5 \pm 0,00005)$ МГц и такой мощности, при которой мощность сигнала на выходе «А1» равна (13 ± 1) дБм. На анализаторе спектра смотрят разность между частотой $(5 \pm 0,00005)$ МГц и гармоническими составляющими $(10 \pm 0,0001)$, $(15 \pm 0,00015)$ МГц и т.д. Минимальное значение в полученных результатах будет равно измеряемому уровню гармонических искажений, вносимых прибором, на частоте 5 МГц на выходе «А1». Аналогично проверяются выходы «А2»-«А4». Для определения гармонических искажений каналов «В» и «С» сигнал подается на соответствующий канал и так же измеряются остальные выходы.

Схема определения гармонических искажений, вносимых прибором, на частотах 10 и 100 МГц аналогичная. Для определения гармонических искажений на частоте 10 МГц используется фильтр нижних частот 10 МГц (ЯКУР.468822.006), а на частоте 100 МГц – фильтр нижних частот 100МГц (ЯКУР.468822.007). Частота на выходе генератора устанавливается соответственно $(10 \pm 0,0001)$ или $(100 \pm 0,001)$ МГц.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученные значения гармонических искажений не более минус 40 дБ для частот 5 и 10 МГц и не более минус 35 дБ для частоты 100 МГц.

Если указанные требования не выполняются, то прибор бракуется и отправляется в ремонт.

8.3.4. Вносимая прибором нестабильность частоты сигналов 5; 10; 100 МГц определяется с помощью компаратора частотного Ч7-314 (VCH-314) или Ч7-318, согласно схеме, приведенной на рисунке 1.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

					ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

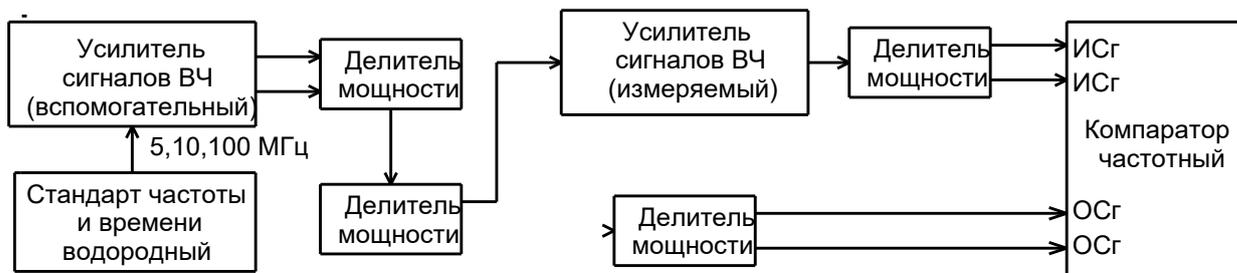


Рисунок 1 – Схема соединения приборов для определения вносимой нестабильности частоты.

В качестве вспомогательного усилителя сигналов ВЧ можно использовать соседний канал измеряемого усилителя сигналов ВЧ. Длины кабелей от вспомогательного усилителя сигналов ВЧ до делителя мощности должны быть одинаковыми. В качестве делителя мощности используется разветвитель ф. Mini-Circuits ZFSC-2-1W-S+ (или аналогичный на диапазон частот не уже 100 МГц). Если стандарт частоты и времени водородный имеет 2 одинаковых выхода, то допускается не использовать вспомогательный усилитель сигналов ВЧ. Измерения производятся на каждом выходе усилителя сигналов ВЧ на частотах 5; 10; 100 МГц при номинальном уровне сигнала $(1,0 \pm 0,1)$ В. В компараторе частотном задаются параметры: коэффициент умножения 10^6 , полоса пропускания флуктуаций частоты 3 Гц. Измерения производятся по методу 3-х генераторов с исключением шумов компаратора. Интервал времени измерения 1 с, число точек не менее 100.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если вносимая нестабильность частоты не более $4,0 \cdot 10^{-14}$.

Если указанные требования не выполняются, то прибор бракуется и отправляется в ремонт.

8.3.5. Определение уровня вносимой прибором спектральной плотности мощности фазовых шумов проводят с помощью анализаторов фазовых шумов TSC 5120A (на частотах 5; 10 МГц), TSC 5125A (на частоте 100 МГц). Источником опорного сигнала служит стандарт частоты и времени водородный. Схема измерения показана на рисунке 2.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

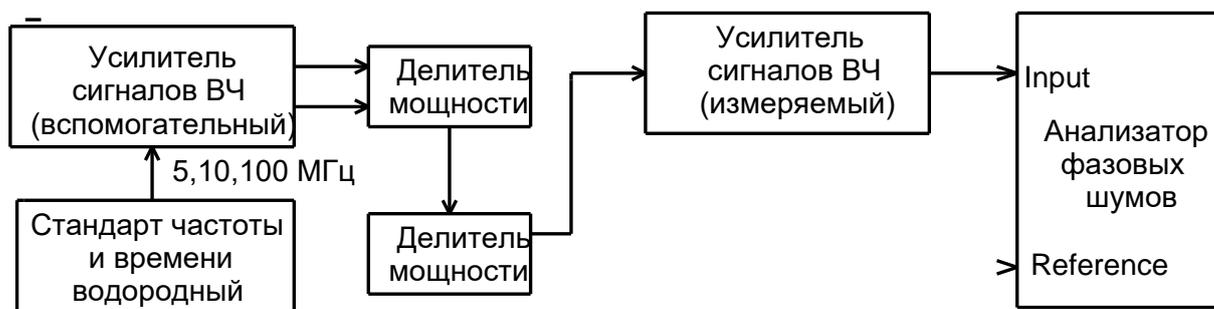


Рисунок 2 – Схема соединения приборов для измерения вносимой прибором спектральной плотности мощности фазовых шумов.

В качестве вспомогательного усилителя сигналов ВЧ можно использовать соседний канал измеряемого усилителя сигналов ВЧ. Длины кабелей от вспомогательного усилителя сигналов ВЧ до делителя мощности должны быть одинаковыми. В качестве делителя мощности используется разветвитель ф. Mini-Circuits ZFSC-2-1W-S+ (или аналогичный на диапазон частот 100 МГц).

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученные значения вносимой прибором спектральной плотности мощности фазовых шумов не более значений, представленных в таблице 4.

Таблица 4 – Уровень вносимой спектральной плотности мощности фазовых шумов, дБ/Гц относительно несущей.

Частотная отстройка, Гц	Частота сигнала, МГц		
	5	10	100
1	-141	-141	-130
10	-150	-150	-145
100	-155	-155	-150
1000	-161	-161	-155
10000	-163	-163	-160

Если указанные требования не выполняются, то прибор бракуется и отправляется в ремонт.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКУР. 468732.022РЭ1	Лист
1	Зам.	ЯКУР.066-2016				14

9 Выключение прибора

9.1. Для того чтобы выключить прибор, необходимо снять переменное напряжение 220 В и постоянное напряжение 24 В.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1	Зам.	ЯКУР.066-2016		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЯКУР. 468732.022РЭ1

Лист
15

